
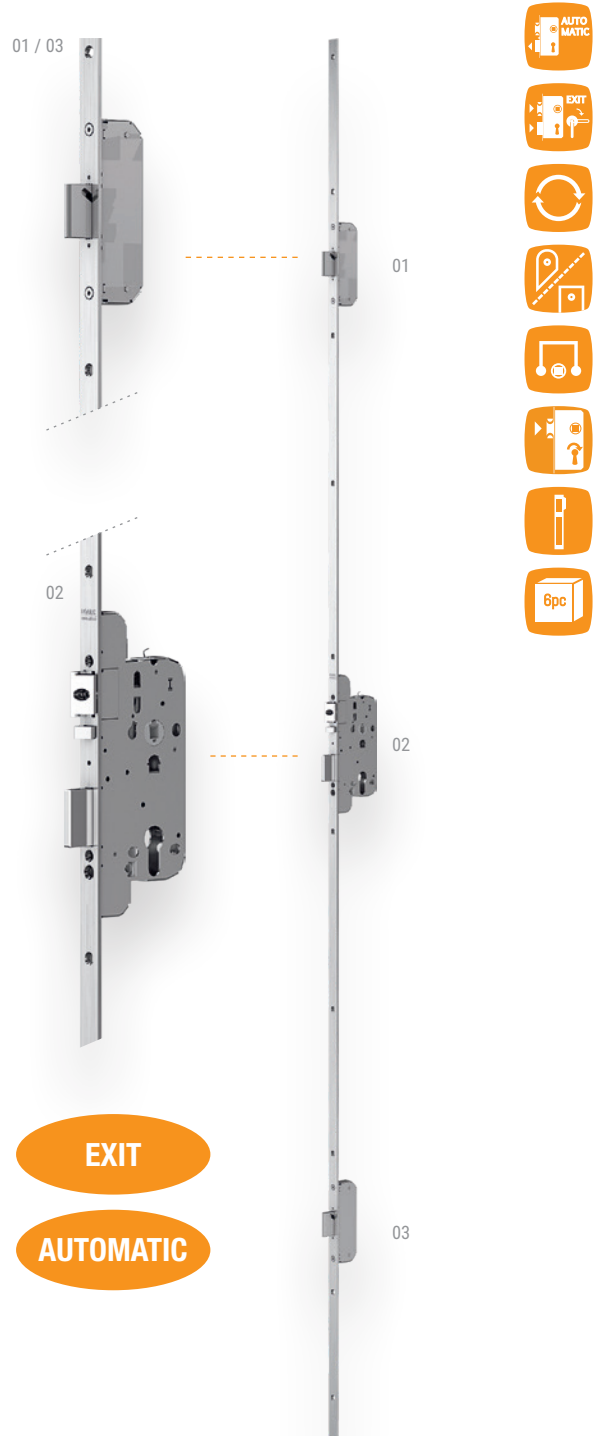


SÉRIE 836

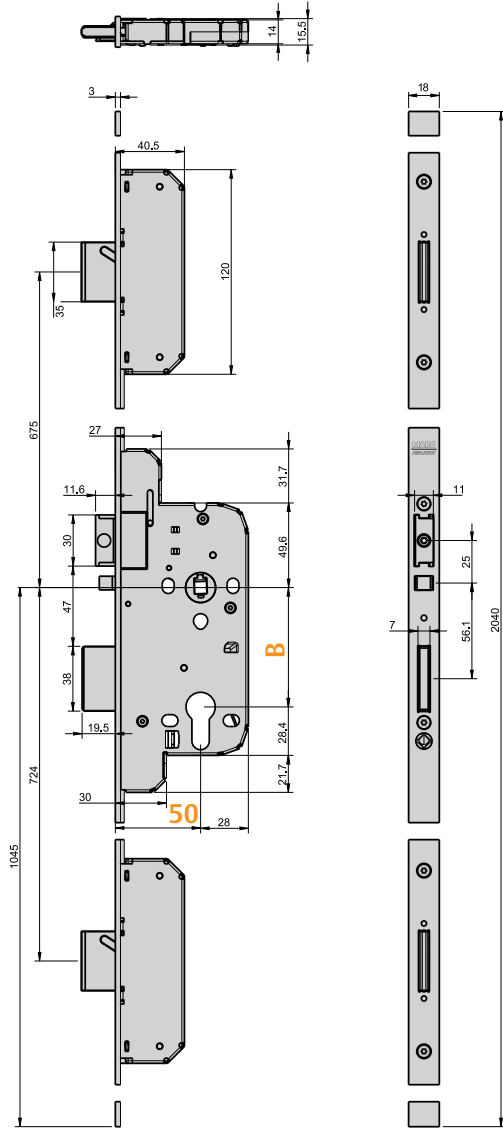

EXIT

AUTOMATIC

NORMA • STANDARD • NORME • NORM • EN12209



Testes realizados no nosso laboratório de fábrica - Tests made in our factory lab
Testes réalisés en notre laboratoire d'usine - Im Marques-Labor geprüft und bestätigt

50	70 / 72	8