


# SÉRIE 425.7

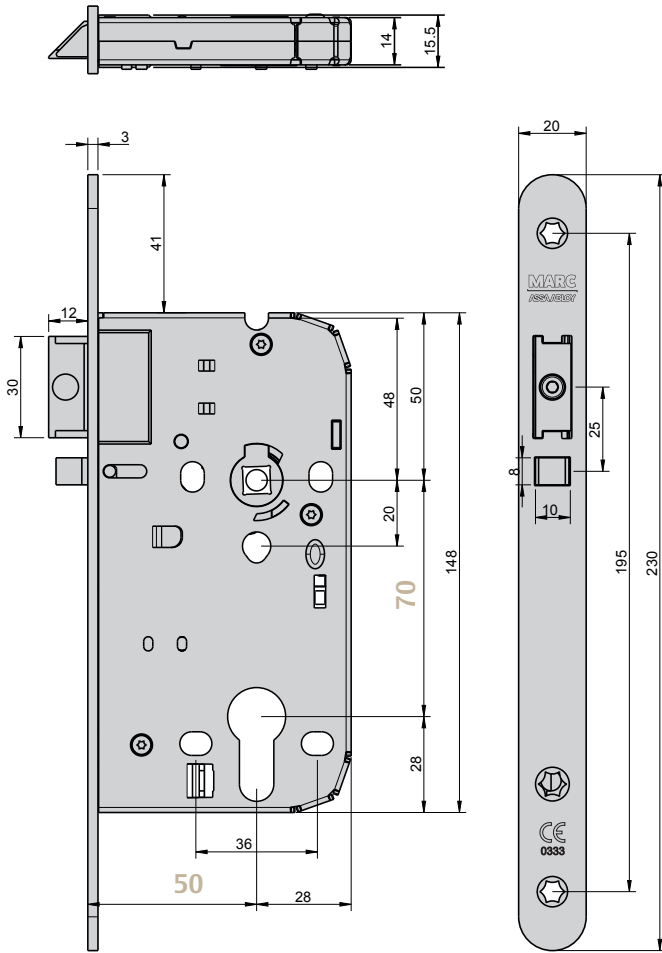

CLASSROOM

OFFICE

ANTIPANIC

NORMA • STANDARD • NORME • NORM • EN 12209:2003+AC:2005



NORMA • STANDARD • NORME • NORM • EN 179:2008



Testes realizados no nosso laboratório de fábrica - Tests made in our factory lab  
 Testes réalisés en notre laboratoire d'usine - Im Marques-Labor geprüft und bestätigt

50	70	8

